

La perfezione in rinoplastica

Set per rinoplastica sec. Prof. G. J. Nolst Trenité



La perfezione in rinoplastica

Set per rinoplastica sec. Prof. G. J. Nolst Trenité





Nella moderna rinoplastica gli approcci atraumatici hanno un'estrema rilevanza.

Il principio fondamentale della rinoplastica è selezionare l'approccio meno traumatico possibile attraverso il quale ottenere i risultati desiderati.


Il nuovo set di strumenti per la rinoplastica, realizzato dal Prof. G. J. Nolst Trenité in collaborazione con KARL STORZ, permette al chirurgo di ottenere eccellenti risultati.

Questo set di alta qualità si compone di un'ampia gamma di strumenti con l'esclusiva rifinitura di colore marrone-dorata.


Utilizzando la tecnica chirurgica del Prof. Nolst Trenité, c'è un minor trauma chirurgico e di conseguenza minori ecchimosi ed edema post-operatori. Inoltre, l'uso delle attuali tecniche chirurgiche riduce gli ematomi e la formazione di tessuto cicatriziale.

Gilbert J. Nolst Trenité, MD PhD

*Professore di otorinolaringoiatria, presidente senior di EAFPS
accademia europea di chirurgia plastica facciale*

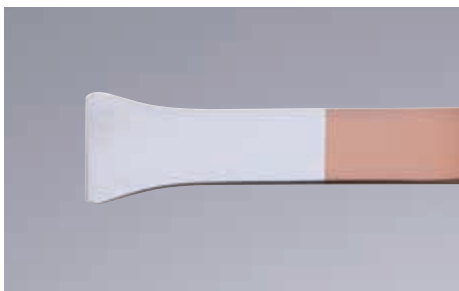

Gli strumenti sono realizzati secondo gli standard KARL STORZ con materiali di elevata qualità.

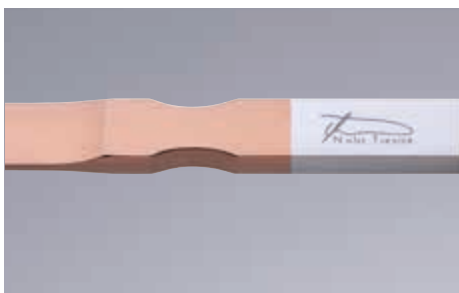

Le caratteristiche di riconoscimento esclusive degli strumenti per rinoplastica sec. Prof. Nolst Trenité sono: la rifinitura di colore marrone-dorata e la firma personale del Prof. Nolst Trenité.

Osteotomi sec. NOLST TRENITÉ



488510



488510

Osteotomo, retto, affilatura bilaterale, arrotondato, con incavi, larghezza taglio 10 mm, lunghezza 18 cm



488512

Osteotomo, retto, affilatura bilaterale, arrotondato, con incavi, larghezza taglio 12 mm, lunghezza 18 cm



488514

Osteotomo, retto, affilatura bilaterale, arrotondato, con incavi, larghezza taglio 14 mm, lunghezza 18 cm



488516

Osteotomo, retto, affilatura bilaterale, arrotondato, con incavi, larghezza taglio 16 mm, lunghezza 18 cm



488518

Osteotomo, retto, affilatura bilaterale, arrotondato, con incavi, larghezza taglio 18 mm, lunghezza 18 cm

Micro-osteotomi sec. NOLST TRENITÉ



488501

- | | | |
|---|--------|--|
|  | 488501 | Micro-osteotomo , retto, affilatura bilaterale, larghezza 2 mm, lunghezza 18 cm |
|  | 488502 | Micro-osteotomo , retto, affilatura bilaterale, larghezza 2,5 mm, lunghezza 18 cm |
|  | 488503 | Micro-osteotomo , retto, affilatura bilaterale, larghezza 3 mm, lunghezza 18 cm |
|  | 488504 | Micro-osteotomo , retto, affilatura bilaterale, larghezza 4 mm, lunghezza 18 cm |

Micro-osteotomi sec. NOLST TRENITÉ



488505

- | | | |
|---|--------|---|
|  | 488505 | Micro-osteotomo , retto, protezione, larghezza 2,2 mm, lunghezza 18 cm |
|  | 488506 | Micro-osteotomo , retto, protezione, larghezza 3 mm, lunghezza 18 cm |
|  | 488507 | Micro-osteotomo , retto, protezione, larghezza 4 mm, lunghezza 18 cm |

Strumenti supplementari



488560



488560

Dissetatore sec. JOSEPH, lunghezza 20 cm



488569

Raspa per glabella, curva, tagliente per pressione e trazione, lunghezza 20 cm



488566



488566

Raspa ossea, in carburo di tungsteno, due estremità, raspa fig. 5 e 6, media, lunghezza 21 cm



488568

Raspa ossea, in carburo di tungsteno, due estremità, raspa fig. 7 e 8, media e sottile, lunghezza 21 cm



488558

Uncino, due denti, affilato, larghezza 10 mm, lunghezza 12 cm



488555



488555

Uncino, un dente, affilato, lunghezza 15 cm



488556

Uncino, due denti, affilato, lunghezza 15 cm



488554 **Retrattore per dorso nasale** sec. AUFRICHT, larghezza uncino 8,5 mm, lunghezza uncino 45 mm, lunghezza 15 cm



174200 **Martello in metallo** sec. COTTLE, lunghezza 18 cm



488540 **Pressa ossea** sec. COTTLE, con clip, superficie utile 5 x 1,5 cm



488541 **Pinza nasale** sec. BLAKESLEY, retta, misura 1, lunghezza operativa 11 cm

Strumenti supplementari



488570 **Portaghi**, ganasce in carburo di tungsteno, lunghezza 13 cm



488545 **Pinza** sec. ADSON-BROWN, atraumatica, denti laterali sottili, lunghezza 12 cm



488546 **Pinza** sec. ADSON, scanalata, lunghezza 12 cm



488547 **Pinza** sec. ADSON, 1 x 2 denti, lunghezza 12 cm



488550 **Forbici angolate** sec. WALTER, lunghezza 10 cm



488551 **Forbici**, extra delicate, curve, lunghezza 10 cm




488552 **Forbici**, extra delicate, rette, lunghezza 10 cm



488553 **Forbici** sec. KILNER, curve, punte piatte, lunghezza 14 cm

VITOM® 3D – Visualizzazione 3D per otorinolaringoiatria e per la chirurgia aperta

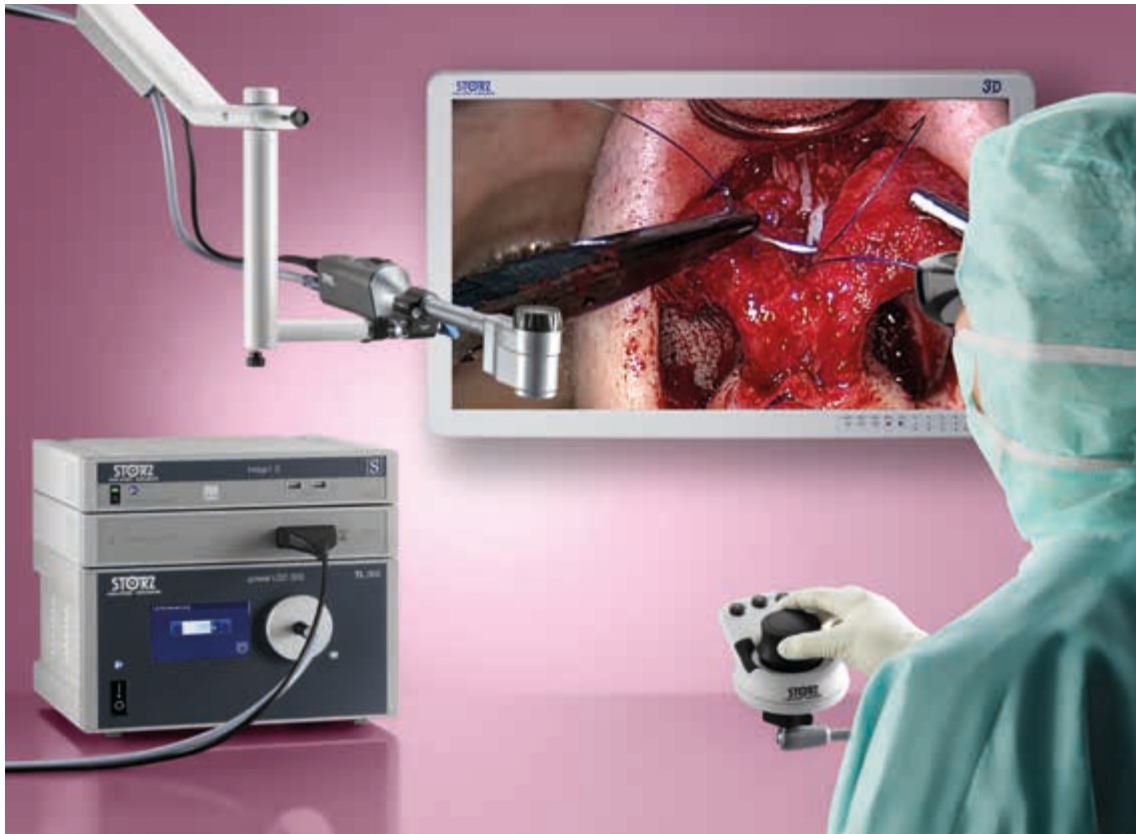

Il sistema VITOM® 3D rappresenta una soluzione rivoluzionaria per la visualizzazione di interventi chirurgici e di chirurgia aperta in molte discipline mediche. Le possibilità di applicazione sono analoghe a quelle di un microscopio operatorio. Il comando delle principali funzioni viene effettuato tramite IMAGE1 PILOT fissato al tavolo operatorio nelle immediate vicinanze del chirurgo.

- Più piccolo, più leggero e compatto di un microscopio operatorio
- Ridotti costi di acquisto e sinergia con l'endoscopia grazie all'integrazione perfetta nella colonna endoscopica: riunisce in un sistema i vantaggi dell'endoscopia e della microscopia
- Ergonomia: l'operatore non è legato all'oculare
- Migliore processo operativo: l'équipe chirurgica può seguire l'intervento con la stessa qualità di immagini del chirurgo

Compendio



Nota bene: VITOM® 3D trova ulteriori campi di applicazione ad es. nella NEUROCHIRURGIA, nella CHIRURGIA DELLA MANO, in CHIRURGIA PLASTICA, nella CHIRURGIA DELLA COLONNA VERTEBRALE, in chirurgia aperta ad es. in CARDIOCHIRURGIA.

VITOM® 3D – Visualizzazione 3D per otorinolaringoiatria e per la chirurgia aperta



- TH 200 **VITOM® 3D**, con funzione di zoom e focus, illuminazione e correzione orizzontale integrate, distanza operativa 20 – 50 cm, con fibre ottiche incorporate, disinfezione esterna con salviette, per impiego con IMAGE1 S CONNECT™ + IMAGE1 S D3-LINK™ + IMAGE1 PILOT



- TC 014 **IMAGE1 PILOT**, unità di comando con rotella per 3D, 4 tasti di funzione programmabili e attacco USB, per il comando intuitivo di sistemi telecamera ed unità collegate, per impiego con IMAGE1 S™ e VITOM® 3D TH 200

È necessario IMAGE1 PILOT per il comando di VITOM® 3D.
VITOM® 3D e IMAGE1 PILOT si utilizzano sempre con un braccio autostatico.
Per il fissaggio di VITOM® 3D al braccio autostatico sono disponibili morsetti di fissaggio specifici.

Dati tecnici:

| | |
|---|------------------------------------|
| Sensori | 4K |
| Zoom | continuo |
| Distanza operativa | 20 – 50 cm |
| Ingrandimento (distanza operativa di 30 cm con monitor 3D da 32") | ca. 8 – 30 x |
| Pulizia | Disinfezione esterna con salviette |

**Braccio autostatico VERSACRANE™
per il posizionamento ergonomico di VITOM®**



28272 HSP **Braccio autostatico VERSACRANE™**, alto, mobile, a molla, con aggancio rapido KSLOCK, per impiego con morsetti di fissaggio KARL STORZ. Il braccio autostatico VERSACRANE™ si utilizza con i sistemi ottici VITOM®.

incluso:

Stativo mobile, per braccio autostatico VERSACRANE™

NOTA BENE: Il braccio autostatico VERSACRANE™ non deve essere utilizzato con endoscopi rigidi.

Si consiglia di verificare l'adeguatezza dei prodotti alle procedure programmate prima dell'uso.

Accessori



28272 VTK **Morsetto di fissaggio VITOM® 3D**, con giunto sferico e aggancio rapido KSLOCK (maschio), per impiego con VITOM® 3D e bracci autostatici KARL STORZ con aggancio rapido KSLOCK



28272 VTP **Morsetto di fissaggio VITOM® 3D**, per POINT SETTER, con attacco a coda di rondine, per impiego con VITOM® 3D e braccio autostatico POINT SETTER



495 VIT **Cavo luce a fibre ottiche**, con attacco retto, termoresistente, grande trasmissione di luce, Ø 4,8 mm, lunghezza 550 cm

Nota bene: Il cavo luce 495 VIT di lunghezza 550 cm si deve utilizzare in combinazione con VERSACRANE™.



TH 001* **Copertura**, per VITOM® 3D, sterile, monouso, confezione da 10 pezzi



TH 002 **Illuminatore VITOM® 3D**, illuminatore supplementare per VITOM® 3D, con una lente regolabile, **autoclavabile**, per impiego con VITOM® 3D e cavo luce



TH 003 **Custodia protettiva**, per VITOM® 3D

Cestello perforato per la pulizia dell'illuminatore VITOM® 3D



Set 2B

39502 ZH **Cestello perforato**, impilabile, con pareti perforate

39502 LH **Coperchio**

39100 SH **Base in silicone LARGE DIAMOND**

39100 PS **Perno di fissaggio**, confezione da 12 pezzi

39360 AS **Pressore in silicone**, confezione da 12 pezzi

Nota bene: Gli strumenti raffigurati non sono compresi nel cestello perforato.

IMAGE1 PILOT con baccio automatico per fissaggio al tavolo operatorio



TC 014 **IMAGE1 PILOT**, unità di comando con rotella per 3D, 4 tasti di funzione programmabili e attacco USB, per il comando intuitivo di sistemi telecamera ed unità collegate, per impiego con IMAGE1 S™ e VITOM® 3D TH 200



28172 HR **Morsetto girevole**, per fissaggio al tavolo operatorio, con vite ad alette premontata 28172 HRS, per guide standard europee e americane, con serraggio laterale per regolazione dell'altezza e dell'angolazione dello stativo articolato



28272 HB **Stativo articolato**, modello rinforzato

04 1150-20* **Copertura**, con estremità elastica, 42 x 164 cm, sterile, monouso, confezione da 20 pezzi, per impiego con bracci autostatici KARL STORZ



Monitor



TM 323 **Monitor 3D da 32"**, incluso:
Alimentatore per monitor, esterno, 24 V
Cavo di rete
 3x **Occhiali di polarizzazione 3D**, antiappannanti, passivi
Copertura cavo



9832 SFH **Base di appoggio per monitor**, per impiego professionale, regolabile in altezza, inclinabile, girevole +/-30°, disinfettabile, colore bianco, con adattatore VESA 200, per impiego con monitor 3D da 32" TM 323



9800 GF **Occhiali di polarizzazione 3D**, antiappannanti, passivi, confezione da 2 pezzi, per impiego con monitor 3D



9800 C **Clip per occhiali 3D**, polarizzazione circolare



STORZ
KARL STORZ—ENDOSKOPE
THE DIAMOND STANDARD

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany
Postfach 230, 78503 Tuttlingen/Germany
Telefon: +49 (0)7461 708-0
Telefax: +49 (0)7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com
www.karlstorz.com

 Health
made in Germany
www.health-made-in-germany.com